

L'aggiornamento delle informazioni di strumenti ed analiti ci aiuta ad assicurarvi che gli esercizi si svolgano con semplicità per voi!

Aggiungi/Aggiorna Strumenti



Prima di aggiornare le informazioni relative agli analiti è necessario effettuare la registrazione degli strumenti.



- 1) Effettua l'accesso (login) con il tuo account Oneworld Accuracy/DigitalPT.
- 2) Dalla pagina iniziale (Home), clicca sull'icona 'Aggiorna Strumenti'.



- 3) Per aggiungere uno strumento, clicca sull'icona 'Aggiungi' a piè pagina.


Per modificare la registrazione di uno strumento, clicca sull'icona 'Modifica strumento registrato' posta vicino al nome dello strumento.

BC1222 Oneworld Accuracy Demo			
Strumenti Registrati			
ID	Ditta Produttrice Modello	Nickname	
58230	Siemens (Prodotti Bayer) Siemens Advia 1800	Advia1	 

←  **Aggiungi** **Modifica strumento registrato** → 

- 4) Appena completata la procedura, clicca sull'icona 'Invia'.

Dati Strumento	
Ditta Produttrice *	<input type="text" value="Siemens (Prodotti Bayer)"/>
Modello *	<input type="text" value="Siemens Advia 1800"/>
Nickname	<input type="text" value="Advia1"/>
Numero di Serie	<input type="text" value="123456789"/>





Aggiungere/Aggiornare Informazioni Analiti per Programmi di Routine

- 1) Dalla pagina iniziale (Home) di Oneworld Accuracy, clicca sull'icona 'Aggiorna reagenti e dosaggi'.
- 2) Trova il programma da aggiornare in 'Iscrizioni anno 2013' e clicca sull'icona 'Analiti/procedure registrati'.


ISCRIZIONI ANNO 2013		Da Esercizio	A Esercizio	Annullato	
▶ 85892	CHEM433	2013/1 - 2013/mar/13	2013/3 - 2013/set/25	<input type="checkbox"/>	    

Analiti/procedure registrati

- 3) Modifica l'iscrizione del programma includendo solo gli analiti che verranno testati.
 - a. Per aggiungere analiti, clicca sull'icona 'Aggiungi' e seleziona gli analiti desiderati.
 - b. Per rimuovere analiti, applica una spunta sul quadrettino corrispondente all'analita da rimuovere e clicca sull'icona 'Cancella'.

Cancella	Analita / Procedura	Strumento	Unità	
<input type="checkbox"/>	Acido Beta-Idrossibutirrico		mmol/L	
<input checked="" type="checkbox"/>				

Modifica analita/procedure registrati



- 4) Per ogni analita in esame, clicca sull'icona 'Modifica analita/procedure registrati' sulla destra dell'analita per rivedere e aggiornare metodologie, strumenti e kit di reagenti.

Analita / Dettagli Procedura	
Unità *	<input type="text" value="mmol/L"/>
Gruppo Valutazione	Fixed Limits
Strumento Registrato*	<input type="text" value="Seleziona uno strumento"/>
Ditta Reagente *	<input type="text" value="Seleziona una ditta produttrice"/>
Numero Catalogo Reagente *	<input type="text" value="Seleziona un Reagente"/>
Sottometodo Reagente *	<input type="text" value="Seleziona un sottometodo"/>
Range di Misura	Inferiore <input type="text"/> Superiore <input type="text"/>



- 5) Assicurarsi che tutte le informazioni siano aggiornate e cliccare sull'icona 'Invia'.

Nota: Se lo strumento o reagente non è presente nell'elenco, cliccare sull'icona "non catalogato" per inviare una richiesta.


Cosa fare se la tua analisi non richiede uno strumento?

La logica del nostro sistema informatico prevede che uno "strumento" sia sempre associato ad un'analisi. Nel caso in cui le analisi non prevedano l'impiego di uno strumento, bensì una determinazione manuale, bisognerà aggiungere la voce 'determinazione manuale' come fosse come uno strumento.

Per aggiungere 'determinazione manuale' all'elenco degli strumenti registrati, seguire gli step riportati sotto.


Dalla pagina iniziale (Home), cliccare sull'icona 'Aggiorna Strumenti'.

- 1) Nella pagina Strumenti Registrati, cliccare sull'icona 'Aggiungi' (+) a piè pagina.

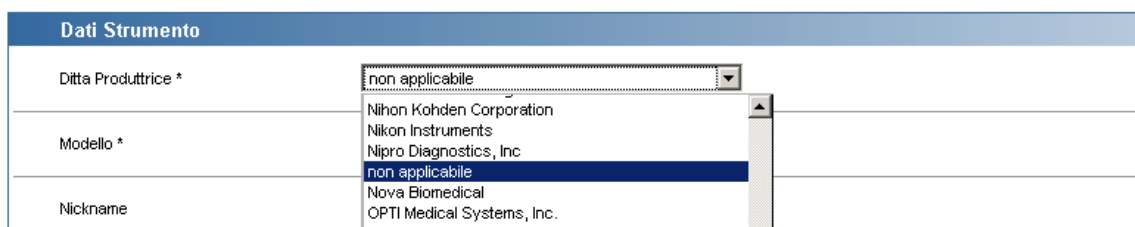





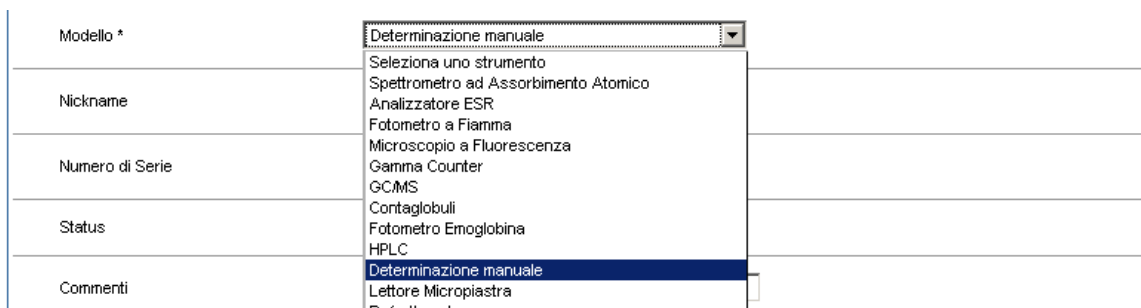



Dati Strumento	
Ditta Produttrice *	non applicabile
Modello *	Nihon Kohden Corporation
	Nikon Instruments
	Nipro Diagnostics, Inc
	non applicabile
	Nova Biomedical
	OPTI Medical Systems, Inc.
Nickname	

- 2) Per la voce Ditta Produttrice, selezionare 'non applicabile'.



Modello *	Determinazione manuale
Nickname	Seleziona uno strumento
	Spettrometro ad Assorbimento Atomico
	Analizzatore ESR
	Fotometro a Fiamma
	Microscopio a Fluorescenza
	Gamma Counter
	GC/MS
	Contaglobuli
	Fotometro Emoglobina
	HPLC
	Determinazione manuale
	Letto Micropietra
	Refrattometro
Numero di Serie	
Status	
Commenti	

- 3) Per la voce Modello, selezionare 'Determinazione manuale'. Nickname e numero di serie, non essendo campi obbligatori, possono essere lasciati in bianco.

ID	Ditta Produttrice Modello	Nickname	
18145	Abbott (Prodotti MediSense) Abbott MediSense 2		 
51688	Biotechnostix Inc. Rapid Response U120 Urine Analyzer		 
18144	non applicabile Determinazione manuale		 
31427	Roche Diagnostics Roche Accu-Chek Aviva		 

- 4) Avendo aggiunto 'Determinazione manuale' come fosse uno strumento, esso va registrato in associazione all'analisi appropriato per completare la registrazione del programma (dall'icona 'Modifica analita/procedure registrati').

Contatta support.it@oneworldaccuracy.com per ulteriori informazioni.

Aggiungere/Aggiornare Informazioni Dosaggi per Programmi Avanzati

- 1) Dalla pagina iniziale (Home) di Oneworld Accuracy, clicca sull'icona 'Aggiorna reagenti e dosaggi'.
- 2) Trova il programma da aggiornare in 'Iscrizioni anno 2013' e clicca sull'icona 'Dosaggi registrati'.

ISCRIZIONI ANNO 2013	Da Esercizio	A Esercizio	Annullato	
▶ 86138	HEPM435	2013/1 - 2013/apr/10	2013/3 - 2013/ott/30	<input type="checkbox"/> [Icone]
▶ 86137	HIVC435	2013/1 - 2013/apr/10	2013/3 - 2013/ott/30	<input type="checkbox"/> [Icone]

Dosaggi registrati

- 3) Modifica l'iscrizione del programma includendo i dosaggi che verranno effettuati.
 - a. Per aggiungere dosaggi, clicca sull'icona 'Aggiungi'.

Dosaggi Registrati

Iscrizione: 83834 - HIVC435 HIV Sierologia

Per questa Iscrizione non ci sono dosaggi registrati.

Dosaggi

<

+

←

Aggiungi

- 4) Il Processo d'Analisi "Rilevazione" è l'unico obbligatorio per il quale bisognerà selezionare la Ditta produttrice del kit in uso presso il laboratorio e il relativo Kit/Sistema d'Interpretazione codificato.
 - a. Una volta selezionati Ditta Kit e Kit/Sistema d'Interpretazione, clicca sulle doppie frecce per salvare il dosaggio scelto.
 - b. Se la Ditta Produttrice o il Kit/Sistema d'Interpretazione non risultasse in elenco, contatta l'Assistenza Oneworld Accuracy.

Aggiungi Dosaggio

Iscrizione 83834 - HIVC435 HIV Sierologia

Nome Dosaggio *

Processo d'Analisi	Ditta Kit	Kit/Sistema Interpretazione
1 Avidità/Neutralizzazione	Seleziona Ditta Produttrice	Seleziona Kit
2 Rilevazione *	Seleziona Ditta Produttrice	Seleziona Kit

Analiti	Unità
< >> ? ?	

Salva Dosaggio

- 5) A questo punto verranno visualizzati gli analiti inclusi nel dosaggio.
 - a. Clicca sulla freccia "Dettagli Processo d'Analisi" per associare un eventuale strumento, se previsto per il dosaggio.
 - b. Fatto questo, clicca sulle doppie frecce per salvare il dosaggio scelto definitivamente.
 - c. Per aggiungere nuovi dosaggi, ripeti i passaggi dal 3 - 5, in base alle tipologie di dosaggi che intendi eseguire.

Aggiungi Dosaggio

Iscrizione 83834 - HIVC435 HIV Sierologia

Nome Dosaggio *

Processo d'Analisi	Ditta Kit	Kit/Sistema Interpretazione
1 Avidità/Neutralizzazione	Seleziona Ditta Produttrice	Seleziona Kit
2 Rilevazione *	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Analiti	Unità
Anti-HIV-1/2 S/Co	
Anti-HIV-1/2 Interpretazione	

< >> ? ?

Salva Dosaggio **Dettagli processo d'analisi**