



## 1. Complete / Revise el Registro de Ensayo

- Haga clic en el botón de Registro de Ensayo

A screenshot of a web-based application interface. At the top, there's a header bar with the text "Tablero del Evento de Evaluación / LABANI - Laboratory Anissa". Below the header, there are several status indicators: "Suscripción: 180903 - TORC435 Serología CMV, Toxoplasma y Rubéola", "Acreditado ISO/IEC 17043:2010", "Plazo para Enviar Resultados: 2020/dic/31 00:00 PST [1/3]", and a link to "Registros de Prueba". Below these are two buttons: "Guardar y Salir" and "Condiciones de Muestra". A horizontal navigation bar follows, with three tabs: "1 Registro de Ensayo" (which is highlighted in red), "2 Condiciones de Muestra", and "3 Resultados de Ensayo". Below this is a button labeled "Registrar Ensayo". At the bottom of the page, there's a footer with the text "Copyright © 2000 - 2020 Oneworld Accuracy Inc. | v20.1.1 | demo-results2 | 03/13/2020 13:44:31 PM".

- Presione Salir si desea finalizar el proceso en otro momento y volver al panel del evento de evaluación. Si el registro del ensayo no está completo o faltan resultados, el icono de registro / resultados permanecerá rojo

## 2. Registre las condiciones de la muestra

- Responda las preguntas referentes a las condiciones de las muestras (marcadas con un \*). Para los programas que se envían anualmente, las respuestas se rellenan previamente en función de las respuestas proporcionadas para el primer evento de prueba.
- Una vez que se han respondido todas las preguntas obligatorias, la pestaña se vuelve azul y el ensayo de la pestaña de resultados se habilita.
- Presione en la pestaña Resultados del ensayo para continuar.
- Presione Salir si desea finalizar el proceso de envío de resultados en otro momento y volver a
- el panel de eventos de prueba. Si la información no está completa o faltan resultados, el icono de resultados permanece rojo en el panel de eventos de prueba.

## 3. Registre los Resultados de Ensayo

- Haga clic en el botón Seleccionar ensayo.
- Seleccione un Ensayo y continue.
- Conteste las preguntas obligatorias referentes a la información de Ensayo (marcadas con \*).



Editar Información de Ensayo

Ensayo: bioMerieux VIDAS CMV IgM ELFA

Información de Ensayo

Tipo de Evaluación -- Haga clic para seleccionar

Corrida 1

Número de Réplicas \* 1

Operador

Director de Laboratorio o Persona Designada (Para laboratorios en EU)

¿Se realizó el ensayo de acuerdo con las instrucciones del fabricante?  Sí  No

¿La corrida fué validada según las instrucciones del fabricante? \*\*  Sí  No

Fecha del Evento de Evaluación

\*obligatorio

Detección: bioMerieux VIDAS CMV IgM ELFA

Número de Lote del Kit

Fecha de Expiración del Kit

Cerrar Agregar Corrida 2

- d. Presione agregar ejecución 2 o agregar ejecución 3 si está probando en varias ejecuciones.
- e. Cierre la pestaña de información de Ensayo y registre los resultados. Puede agregar un nuevo ensayo en cualquier momento haciendo clic en el botón Seleccionar ensayo. Puede editar la información del ensayo haciendo clic en Editar ensayo.

Editar Información de Ensayo

Seleccione un Ensayo: bioMerieux VIDAS CMV IgM ELFA

Continuar Cancelar

Copyright © 2000 - 2020 OneWorld Accuracy Inc. | v20.3 | demo-results1 | 03/20/2020 10:45:27 AM



- f. Para los programas con una sola corrida y réplica, los resultados se envían en una cuadrícula. Por determinado, los analitos se muestran en filas para permitir el envío por muestra. Puede cambiar el modo de envío de resultados por analito. Las muestras aparecen conforme en los renglones. Puede volver a la pestaña anterior y enviar los resultados por muestra en cualquier momento.

A screenshot of the oneworld ACCURACY software interface. At the top, there's a navigation bar with icons for file operations like 'Nuevo', 'Abrir', 'Guardar', etc. Below the bar, there are two main sections: 'Corrida 1' and 'Interpretación de Ensayo'.  
  
**Corrida 1:** This section has a title 'Analito' and a 'Réplica 1' button. A row shows 'Anti-CMV IgM - Índice' and 'Control interno inhibido'. There's also a 'Copiar' icon. Below this is a button 'Agregar Corrida 2'.  
  
**Interpretación de Ensayo:** This section has a title 'Analito' and an 'Interpretación' button. It shows 'Anti-CMV IgM Interpretación' and a dropdown menu '--Seleccione el Resultado--'. There's also a warning icon.  
  
The interface uses a light gray background with blue and yellow highlights for buttons and status indicators.

- g. Para programas con múltiples ejecuciones y réplicas, los resultados son enviados por muestra. Los resultados se guardan tan pronto salga de una celda.

★ indica que el resultado es obligatorio.

Un ícono rojo **A**, indica que no se han ingresado todos los resultados obligatorios.

Un ícono azul **B**, indica que se han ingresado todos los resultados obligatorios.

El nombre del ensayo se vuelve azul cuando se han ingresado todos los resultados obligatorios para un ensayo.

La pestaña Resultados del ensayo se vuelve azul cuando se han ingresado todos los resultados obligatorios para todos los ensayos.

Para ingresar un problema analítico, haga clic en .

Para regresar al modo de resultados, haga clic en .

Para ingresar un comentario, haga clic en . Los resultados con comentarios se identifican con el icono .

Para cambiar el ancho de una columna, haga clic y arrástrela con el mouse .



Ensayo: bioMerieux VIDAS CMV IgM ELFA

A B C D E

Corrida 1

Analito Réplica 1 +

Anti-CMV IgM - Índice !

Corrida 2

Borrar Corrida 2

Analito Réplica 1 +

Anti-CMV IgM Index !

+ Agregar Corrida 3


Interpretación de Ensayo

Analito Interpretación

Anti-CMV IgM Interpretación --Seleccione el Resultado-- !

This screenshot shows a laboratory software interface for a CMV IgM ELFA assay. At the top, there's a header with the assay name and a toolbar with icons for cancel and edit. Below the header, there are five tabs labeled A through E. Under tab A, there's a section for 'Corrida 1' (Run 1) which contains an 'Analito' (Analyte) table with a single row for 'Anti-CMV IgM - Índice'. The result cell is highlighted in green with a yellow exclamation mark icon. There are buttons for adding more runs and deleting the current one. Under tab B, there's a section for 'Corrida 2' (Run 2) with a similar structure. Below the runs, there's a section for 'Interpretación de Ensayo' (Assay Interpretation) with an 'Analito' table for 'Anti-CMV IgM Interpretación'. The result cell here also has a yellow exclamation mark icon. There's a button to add more interpretations.

Haga clic en el botón "Preferencias de resultados" para actualizar su separador decimal y de agrupación de dígitos preferencias:

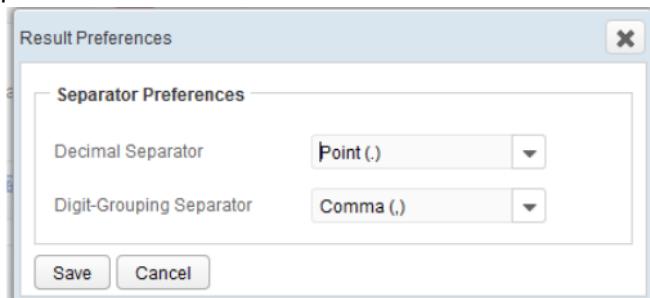



- Haga clic para contraer un ensayo.
- Haga clic para expandir un ensayo.
- Haga clic para contraer una ejecución o una interpretación de ensayo.
- Haga clic para expandir una ejecución o una interpretación de ensayo.
- Puede agregar una ejecución o una réplica haciendo clic en .
- Puede eliminar un ensayo, una ejecución o una réplica haciendo clic en

- h. Una vez que ingresó los resultados para todos los ensayos, si hay interpretaciones finales disponibles para el programa, presione en la pestaña Interpretación final para continuar.
- i. Presione Salir si desea finalizar el proceso de envío de resultados en otro momento y volver al panel de eventos de prueba. Si faltan resultados, el ícono de Resultados permanece rojo .

#### 4. Ingrese las interpretaciones finales

Las interpretaciones finales están disponibles solo para algunos programas. En algunos casos, interpretaciones finales solo están disponibles si se usa más de un ensayo para la prueba.

##### a. Ingrese los resultados para las interpretaciones finales.

The screenshot shows a software interface for entering final interpretations. At the top, there are four tabs: Assay Registration (selected), Sample Conditions, Assay Results, and Final Interpretations. Below the tabs, there is a header labeled 'HBV Serology Status' with a dropdown menu. The main area contains a table with columns for Analyte, Anti-HBs Interpretation, HBV Serology Status, and Refer for Further HBV Testing. Each row has a status indicator (A, B, C, D) and a red X icon. The 'Anti-HBs Interpretation' column shows 'Abbott ARCHITECT Anti-HBs CMI Negative'. The 'HBV Serology Status' column contains dropdown menus with various options. The 'Refer for Further HBV Testing' column also contains dropdown menus. A legend at the bottom left indicates that a blue star icon means the result is required.

Los resultados se guardan tan pronto como salga de una celda.

indica que el resultado es obligatorio.

Un ícono rojo , indica que no se han ingresado todos los resultados obligatorios.

Un ícono azul , indica que se han ingresado todos los resultados obligatorios.



La pestaña Interpretaciones finales se vuelve azul cuando se han ingresado todos los resultados obligatorios.

Para ingresar un problema analítico, haga clic en .

Para regresar al modo de resultados, haga clic en .

Para ingresar un comentario, haga clic en . Los resultados con comentarios se identifican con el ícono .

Para cambiar el ancho de una columna, haga clic y arrástrela con el mouse.

Haga clic para contraer la interpretación final.

Haga clic para expandir.

- j. Presione Salir, una vez terminado de ingresar todas las interpretaciones finales. Si la información no está completa o faltan resultados, el ícono Resultados permanece rojo en el Tablero de eventos de prueba.

Haga clic en Preferencias de entrega de informes para cambiar sus preferencias:

